

Zoomセミナー開催のお知らせ (栄養関連コネクター変更のご案内)

コロナ禍において大人数での勉強会は不安との声にお応えし、施設単位での栄養関連誤接続防止コネクターセミナーを開催致します。

《 具体的流れ 》

- ▶ 病院ご担当者様とメールで連絡を取り合います。
- ▶ 希望日時を確認させていただきます。
- ▶ 弊社担当者からZoom開催の詳細をメールにてご連絡させていただきます。
- ▶ セミナーは25分を予定しております。
- ▶ 質問ご意見等は病院ご担当者様が集約して頂き、後日メールでご回答させていただきます

【申込先】(株)トップ宮崎出張所 小木俊博 <携帯> 080-5927-5904

MedicalCare STATION

あなたのその疑問に医療機器メーカーが
お答えします！

そうだ！

メーカーに聞こう！



医療介護連携のための
コミュニケーションツールに

医療機器メーカーの**トップ**が
コミュニティを開設しました



ISO80369-3コネクタ変更について


変更形状




	栄養セット側(上流)	栄養カテーテル側(下流)
旧規格		
	オス	メス
新規格 (ISO 80369-3)		
	メス	オス

新規格製品では、
既存規格製品と
**接続の向き【オスメス
(凸凹)】が変更**
となります。

変更箇所

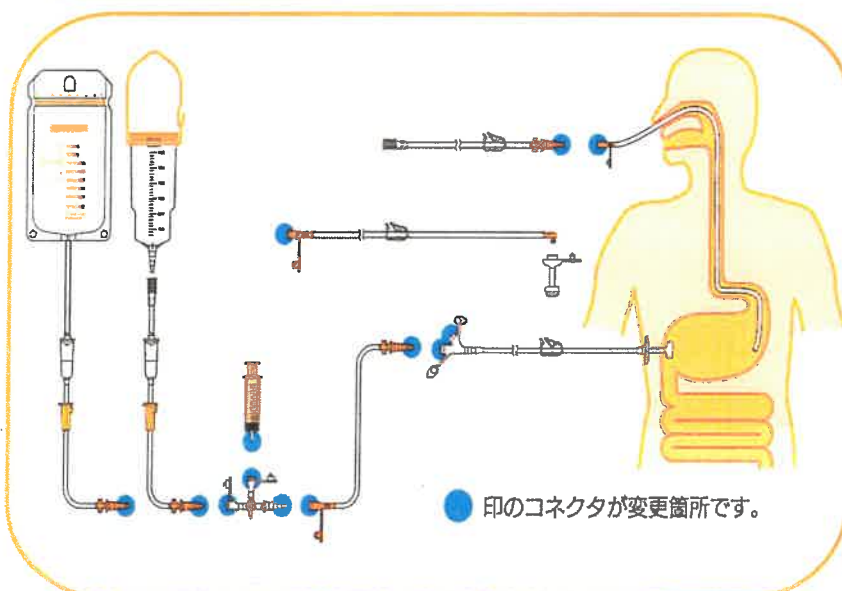

対象除外箇所

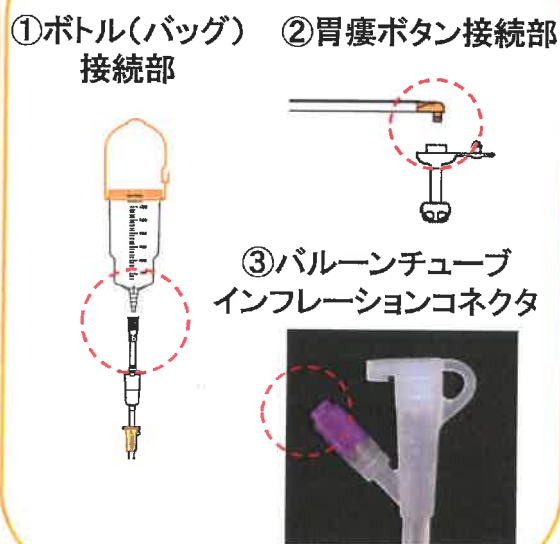

推奨カラー

オレンジ又は**パープル**

フードカラーの**オレンジ**をおすすめ致します。

切り替え期間2021年11月末まで